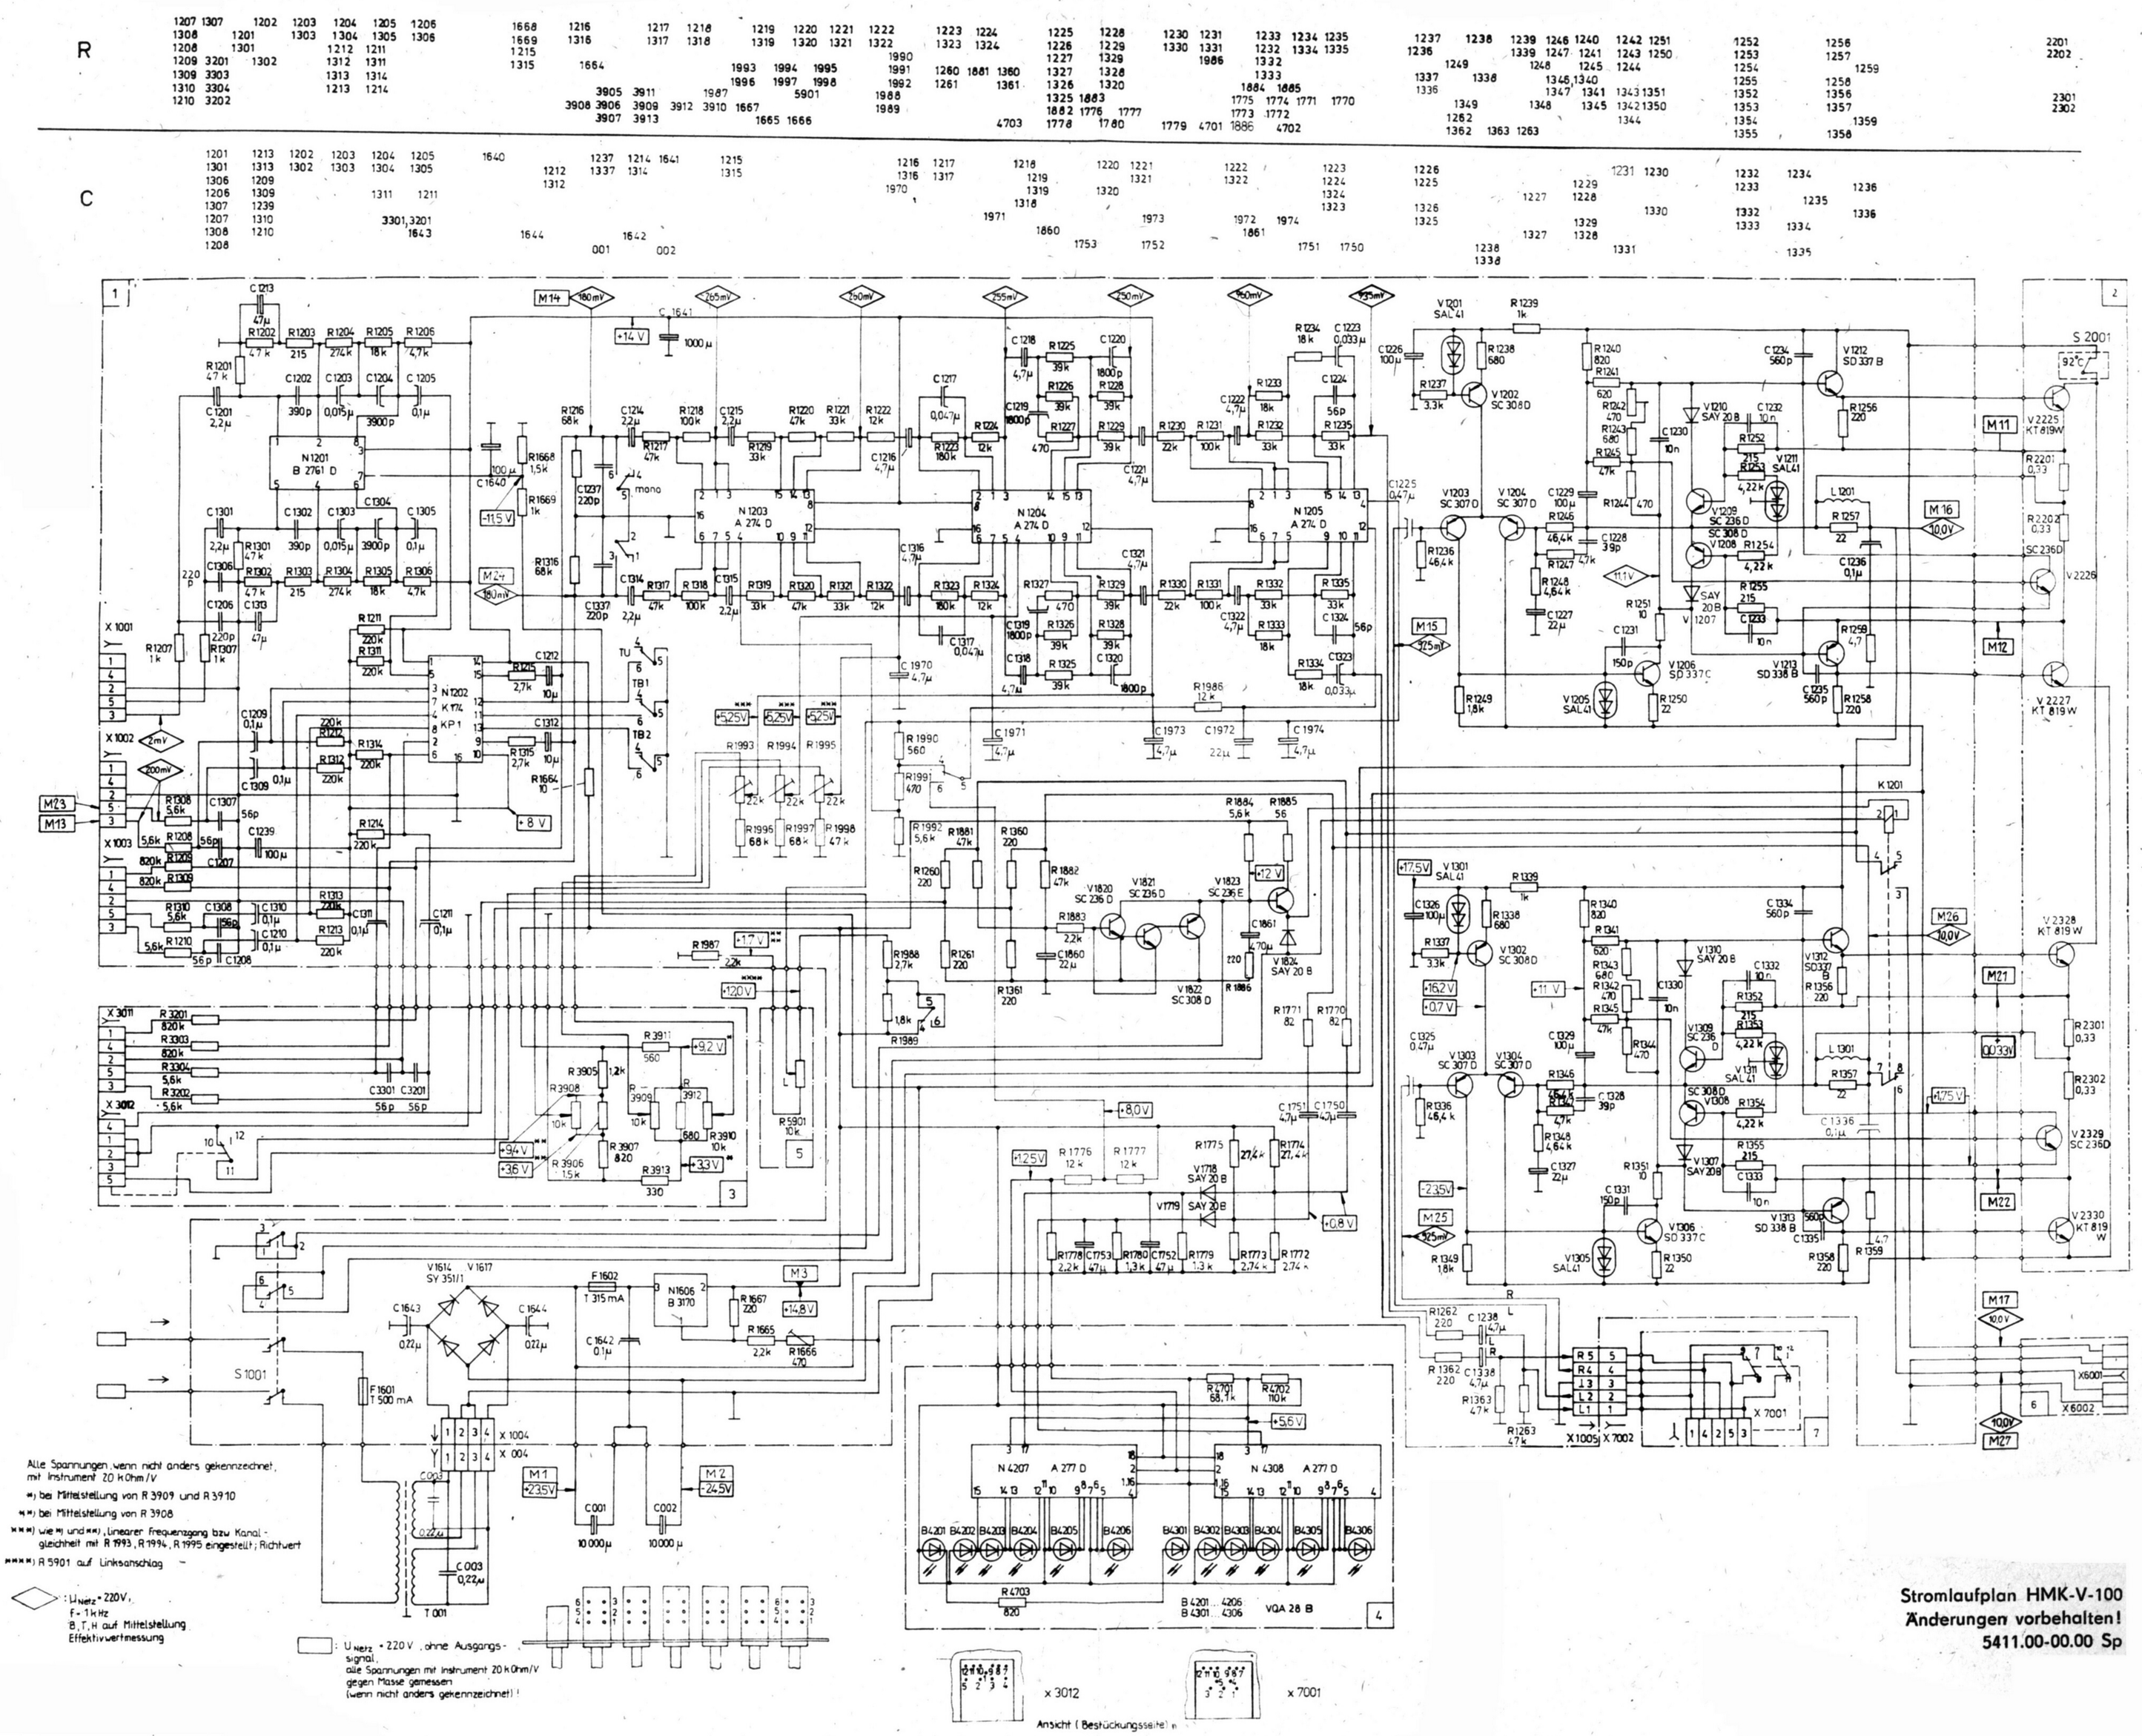

Alle Spannungen, wenn nicht anders gekennzeichnet, mit Instrument 20 kOhm/V

*) bei Mittelstellung von R 3909 und R 3910

**) bei Mittelstellung von R 3908

***) wie *) und **), linearer Frequenzgang bzw. Kanalgleichheit mit R 1993, R 1994, R 1995 eingestellt; Richtwert

****) R 5901 auf Linksanschlag

◇: U_{Netz} = 220 V; f = 1 kHz B, T, H auf Mittelstellung Effektivwertmessung

□: U_{Netz} = 220 V, ohne Ausgangssignal, alle Spannungen mit Instrument 20 kOhm/V gegen Masse gemessen (wenn nicht anders gekennzeichnet)!

Stromlaufplan HMK-V-100
Änderungen vorbehalten!
5411.00-00.00 Sp