



Spannungen mit Instrument 333Ω/V 600V-Meßbereich gemessen

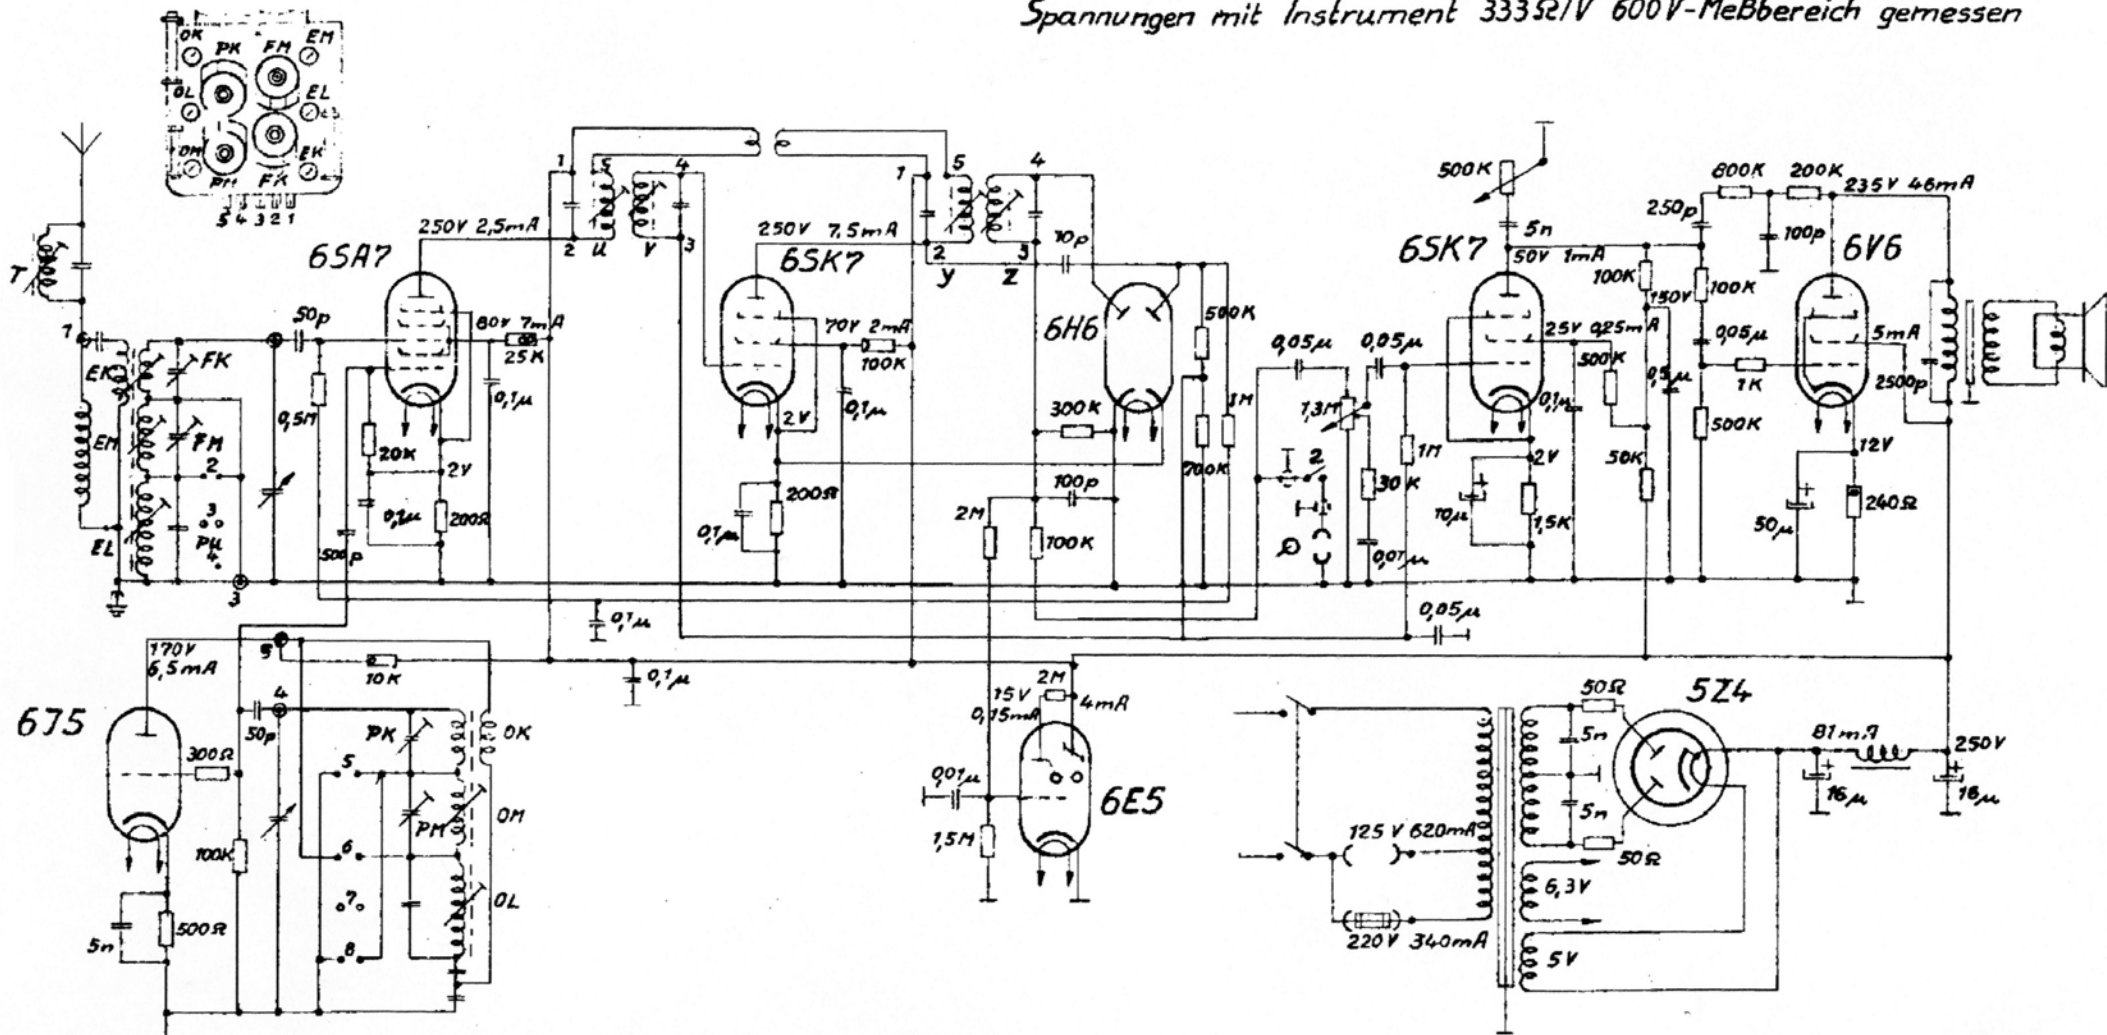

Schalter-Diagramm

Bereich	1	2	3	4	5	6	7	8
K 20 - 5,9 MHz								
M 1620 - 520 kHz								
L 425 - 150 kHz								
T Tonabnehmer								

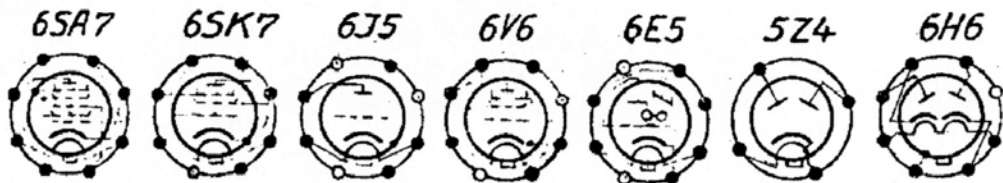

GFGF e.V.

Bel Ami AHS 6823-D

Ing. Heinz Blohm
Plauen (Vogtl.)